



PROPOSTAS



CIRÚRGICA GRALHA AZUL

PRODUTOS HOSPITALARES

000431

Alves e Sartor Ltda

CNPJ:07.724.523/0001-20 – Inscrição Estadual: 903.57503-44

Rua Souza Naves, 3223 – Centro – Cascavel – Paraná

Tel:45 3222-2376 / Fax: 45 3223-4806

www.cirurgicagralhaazul.com.br – contato@cirurgicagralhaazul.com.br

PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Município de FRANCISCO BELTRÃO
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de produtos e materiais a serem utilizados na Central de Material Esterilizado – CME da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA 24 horas

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07 de novembro de 2018 às 09h00min

DECLARO SER EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
15	1000	UN	Hipoclorito de sódio 1%: desinfetante hospitalar para superfícies fixa e artigos não críticos, à base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm). Possui ação bactericida, desinfetante, germicida e virucida, atuando como elemento oxidativo em cadeias proteicas de microrganismos. Apresentação: Caixas com 12 frascos plásticos lacrados com 1 litro, constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade).	CICLOFARM A	7,40	7.400,00
18	20	UN	Lubrificante de instrumental cirúrgico Indicado para prevenção de corrosão, ferrugem, manchas e enrijecimento de instrumentais cirúrgicos. Pronto para o uso. Apresentação: embalagem de 01 litro. Constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade).	MAXSLIP RIOQUIMICA	62,93	1.258,60
Total Global:						8.658,60
OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, E SESSENTA CENTAVOS.						

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais; 000432

PRAZO DE ENTREGA: A empresa vencedora detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico.

PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva Nota Fiscal e CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Se vencedora da licitação, assinará o contrato, Ata de Registro de preços é Responsável pelo os pedidos, na qualidade de representante legal o Sr. ODAIR JOSÉ SARTOR portador da Carteira de Identidade RG nº 5.725.605-2/SSP-PR e CPF nº 020.887.939-09. Endereço do representante legal: RUA RIO DE JANEIRO, 1117, CENTRO, CASCAVEL - PARANÁ e e-mail: odairsartor@hotmail.com. telefone: 45-32234806.

Cascavel, 07 de Novembro de 2018.

07.724.523 / 0001 - 20

ALVES E SARTOR LTDA.-ME

Rua Souza Naves, 3223
Centro - CEP 85802-080
CASCAVEL - PARANÁ

Odair José Sartor
Sócio-Administrador
RG nº 5.725.605-2 SSP-PR
CPF 020.887.939-09



PROPOSTA COMERCIAL	
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2018 UASG Nº 987565
Razão Social	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA – EPP
CNPJ/ I.E/IM	14.793.395/0001-31/ 001890322.00-05/4366730013
Endereço	RUA ARISTÓTELES CALDEIRA, 915, BAIRRO BARROCA, BELO HORIZONTE – MG. CEP 30.431-054
Telefone / Fax	31-3654-3926 OU 31-3654-3925
Representante Legal/Cargo/ RG E CPF	AMILTON GONÇALVES SOARES/DIRETOR ADMINISTRATIVO/ RG M8. 236.317/ CPF 033.648.036-92
Endereço eletrônico (e-mail)	cbepi@cbepi.com.br / lucellia.cbepi@outlook.com
Banco - Agência – C/C	ITAÚ/ 3158/ 38118-0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	Preço unit. R\$	Preço total R\$
01	Avental frontal impermeável, na cor branca, tamanho a definir Com proteção contra respingos e pequenos jatos de líquidos, Com 4 alças, acabamento com bainha dupla, apresentação: und. Indicada para uso hospitalar/lavanderia e cozinha. MARCA: BRASCAMP – CA 28303	80	UND	26,50	2.120,00
Valor total da proposta: R\$ 2.120,00 (Dois mil, cento e vinte reais)					

Belo Horizonte, 28 de Novembro de 2018.


 Amilton G. Soares
 CI: M8 236317
 CPF nº 033.648.036-92
 Amda Security Importadora Ltda


14.793.395/0001-31
 AMDA SECURITY IMP. LTDA. - ME
 RUA ARISTÓTELES CALDEIRA, Nº 915
 BAIRRO BARROCA - CEP 30431-054
 BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Amda Security Importadora Ltda. – EPP – Cnpj: 14.793.395/0001-31 – IE 001890322.00-05
 Rua: Aristóteles Caldeira, 915, Bairro: Barroca, Belo Horizonte – MG, CEP 30.431-054.
 Tel.: (31) 3654-3926 * Fax: (31) 3654-3925 – E-mail: cbepi@cbepi.com.br



2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

2.2. Declaramos que nos **preços unitários e totais** propostos se incluem os produtos, ICMS, mão - de - obra de fabricação, armazenamento, transporte, carga e descarga, leis sociais, impostos municipais, estaduais e federais, encargos e custos financeiros, custos de embalagem, frete, seguro, armazenamento provisório na fábrica, carga, transporte e descarga, enfim, tudo o que for necessário para o fornecimento e entrega dos produtos, objeto da licitação, postos no local definido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**.

- **Prazo de entrega:** Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de acordo com as solicitações da Secretaria de Secretaria Municipal de Saúde, na sede da Unidade de Pronto Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030 CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103 Página 25 Atendimento 24 horas – UPA 24 horas, localizada na Rodovia Perimetral Norte, nº 1.510, bairro Padre Ulrico, no Município de Francisco Beltrão
- **Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias.
- **Prazo de Garantia dos Produtos:** 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação.

Belo Horizonte, 28 de Novembro de 2018.



 Arnilton G. Soares
 CT: M8 236317
 CPF nº 039.648.036-92
 Amda Security Importadora Ltda


 AMDA SECURITY IMP. LTDA. - ME
 RUA ARISTÓTELES CALDEIRA, Nº 915
 BARRIO BARROCA - CEP 30431-054
 [BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS]

Amda Security Importadora Ltda. – EPP – Cnpj: 14.793.395/0001-31 – IE 001890322.00-05
 Rua: Aristóteles Caldeira, 915, Bairro: Barroca, Belo Horizonte – MG, CEP 30.431-054.
 Tel.: (31) 3654-3926 * Fax: (31) 3654-3925 – E-mail: cbepi@cbepi.com.br

000435

São Paulo, 07 de Novembro de 2018.

Para: Prefeitura de Francisco Beltrão

A/C: Comissão de Licitações

Pregão: 206/2018

Processo: 834/2018



PROPOSTA COMERCIAL

all

DADOS CADASTRAIS

NOME	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	08.924.875/0001-91
INSC. MUNICIPAL	3.651.8468
INSC. ESTADUAL	149.727.865.112
ENDEREÇO	Rua Antonio Fonseca, 285 - CEP 02112-010 Vila Maria - São Paulo - SP
EMAIL	licitacoes@biovalic.com.br
TELEFONE / FAX	(11) 2361-8908/ 2361-8909

RAMOS DE ATIVIDADE

46.64-8-00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.45-1-01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
47.73-3-00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
33.19-8-00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
95.11-8-00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

RESPONSÁVEL LEGAL

NOME	LETICIA LIMONTA LASSALA MADIO
RG	43.705.597-8 SSP-SP
CPF	344.218.988-80
NACIONALIDADE	BRASILEIRA
CARGO	DIRETORA GERAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME	LILIAN CRISTINA COSTA MARCONDES
COREN	306306 SP

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	Banco do Brasil
AGÊNCIA	0584-3
CONTA CORRENTE	45326-9

all

**ITEM 02****PACOTES DE BOWIE & DICK**

É desenvolvido para controlar a penetração do vapor e a remoção do ar residual das autoclaves a vácuo. Composto por uma série de barreiras, papel cartão poroso. Permeáveis ao vapor entre as quais se encontra uma folha de indicador químico. Os Pacotes de Testes Bowie & Dick são impressos com tinta Chemink de alta qualidade, livre de metais pesados tóxicos. O indicador químico interno muda de 'Amarelo' para 'Preto' indicando uma adequada eliminação do ar. Permite registrar na própria folha teste as informações referentes ao processo de esterilização como: data, número de controle do ciclo, etc. O produto apresentado tem a medida aproximada de 12,5cm X 12,5cm e foi desenvolvido e fabricado seguindo os parâmetros determinados pelas normas EN 867 e ISO 11140 (parte 1 a 5) (4 kilos) e sob os certificados de gestão de qualidade ISO.

Fabricante: TERRAGENE - Marca: CHEMDYE - Modelo: BD125X/2

Procedência: IMPORTADO ARGENTINA

Apresentação: CAIXA COM 20 UNIDADES

Registro ANVISA: ISENTO RDC 185

Validade: DE 05 ANOS

Código Alfandegário: 38220090

Certificações: ISO 9001, ISO 13485, (BPF) Boas Práticas de Fabricação

Quantidade: **600 unidades**

Valor Unitário **R\$ 16,87 (Dezesseis Reais e Oitenta e Sete Centavos).**

Valor Total **R\$ 10.122,00 (Dez Mil Cento e Vinte e Dois Reais).**

ITEM 08**INDICADOR QUÍMICO INTERNO CLASSE VI**

Os integradores EMULADORES classe 6 evidenciam a existência do agente esterilizante específico para qual têm sido desenvolvido. As tiras integradoras são designadas para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor quando 95% do ciclo estiver concluído (tempo, temperatura e qualidade do vapor) dentro de um intervalo específico do ciclo de esterilização. Devem ser colocados no interior de cada pacote, no local de maior dificuldade de penetração do agente esterilizante. Permite fácil leitura através da mudança de cor. Único no mercado com tinta isenta de metais pesados, inclusive chumbo. (07 minutos por 134°C) ou (20 minutos por 121°C)

Fabricante: TERRAGENE - Marca: INTEGRON - Modelo: IT27 7YS

Procedência: IMPORTADO ARGENTINA

Apresentação: CAIXA

Registro ANVISA: ISENTO RDC 185

Validade: De 05 Anos

Código Alfandegário: 38220090

Certificações: ISO 9001, ISO 13485, (BPF) Boas Práticas de Fabricação.

Quantidade: **5.000 unidades**

Valor Unitário **R\$ 0,27 (Vinte e Sete Centavos).**

Valor Total **R\$ 1.350,00 (Hum Mil Trezentos e Cinquenta Reais).**

all

**ITEM 14**

INDICADOR QUÍMICO CLASSE I - ETIQUETAS PARA ETIQUETADORA Para Registros dos Processos de Esterilização, com as seguintes especificações: Classificação: Classe 1 (ISO 11140-1 – EN867-1) pois possui indicador de processo. Impressão: 3 linhas de impressão. Tamanho: 21mm x 26 mm. Composição: Tinta indicativa Chemink de alta qualidade, isenta de chumbo e metais pesados. Disponíveis para: Vapor. Característica: Dupla camada adesiva que possibilita colar a etiqueta no artigo a ser esterilizado e posteriormente nas fichas de controle para rastreabilidade. Aplicação: Em todas as embalagens submetidas ao processo de esterilização. Leitura do Resultado: As tiras mudam de cor quando exposta ao processo, identificando os envoltórios sem precisar abrir e identificando os itens processados dos não-processados de forma rápida e fácil.

Fabricante: TERRAGENE - Marca: CHEMDYE - Modelo: CD23

Procedência: IMPORTADO ARGENTINA

Apresentação: CAIXA 12 Rolos contendo 750 etiquetas cada.

Validade: 01ano.

Registro ANVISA: ISENTORDC 185

Certificações: ISO 9001, ISO 13485, (BPF) Boas Praticas de Fabricação.

Quantidade: **20 caixas com 12 rolos contendo 750 etiquetas cada**

Valor Unitário **RS 930,00 (Novecentos e Trinta Reais).**

Valor Total **RS 18.600,00 (Nove Mil Seiscentos Reais).**

ITEM 16

INDICADOR BIOLÓGICO para vapor do tipo auto-contido de terceira geração, com tempo de resposta de no máximo 3 (três) horas por método fluorescência, indicado para o controle biológico de ciclos de esterilização à vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vacuo ou gravitacionais. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de *Geobacillus Stearothermophilus* (ATCC 7953), com laudo de qualidade assegurada, acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro lacrada com meio de cultura púrpura, fechada com tampa com abertura superior para penetração do vapor e protegida por papel hidrofóbico que atua como barreira bacteriana e indicador químico externo e contendo etiqueta com indicador de processo.

Fabricante: TERRAGENE - Marca: SISPACK - Modelo: SP220

Procedência: IMPORTADO ARGENTINA

Apresentação: CAIXA 50 unidades.

Registro ANVISA: ISENTORDC 185

Validade: DE 02 ANOS

Código Alfandegário: 38210000

Certificações: ISO 9001, ISO 13485, (BPF) Boas Praticas de Fabricação, Laudo Analítico de laboratório credenciado ao REBLAS ANVISA

Quantidade: **09 caixas com 25 unidades**

Valor Unitário **RS 1.090,00 (Hum Mil e Noventa Reais).**

Valor Total **RS 9.810,00 (Nove Mil Oitocentos e Dez Reais).**

all
24

**ITEM 17****INDICADOR QUÍMICO INTERNO CLASSE V -**

Os integradores são designados para evidenciar a existência do agente esterilizante específico para qual têm sido desenvolvido. As tiras são designados para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e qualidade do vapor), dentro de um intervalo específico de ciclos de esterilização. Produto inovador, pois é livre de materiais pesados, inclusive chumbo. Produto em conformidade com as normas (ISO 11140-1 e EN 867)

Fabricante: TERRAGENE - Marca: INTEGRON - Modelo: IT26-1YS

Procedência: IMPORTADO ARGENTINA

Apresentação: CAIXA

Registro ANVISA: ISENTO RDC 185

Validade: De 05 Anos

Código Alfandegário: 38220090

Certificações: ISO 9001, ISO 13485, (BPF) Boas Práticas de Fabricação

Quantidade: **20.000 unidades**

Valor Unitário **R\$ 0,35 (Trinta e Cinco Centavos).**

Valor Total **R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais).**

ITEM 20**PACOTE TESTE DESAFIO (PCD)**

Desenvolvido para verificar a penetração de vapor em autoclaves. O teste de prova avalia o correto funcionamento da autoclave a vapor expondo o equipamento aos teste mais rigorosos segundo a AAMI e ISO, com indicador biológico de terceira geração (leitura rápida Geobacillus Stearothermophilus) com uma população mínima de 100.000 (cem mil) esporos, do tipo auto-contido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor. Produto desenvolvido em conformidade com as normas ISO 11.140 e 11.138). O pacote possui uma serie de barreiras de papel poroso, 01 Indicador de processo externo CLASSE I, 01 Indicador biológico por método de fluorescência com resposta final em ate 3hs, 01 indicador biológico por método de fluorescência com resposta final em ate 3hs PILOTO, 01 Integrador químico Classe V que reagir a todos os parâmetros processo de esterilização (tempo, temperatura e qualidade do vapor) e um sistema autoadesivo, e com tampa permeável ao vapor e contendo etiqueta com indicador de processo.

Fabricante: TERRAGENE - Marca: BIONOVA - Modelo: PCD220/1

Procedência: IMPORTADO ARGENTINA

Apresentação: CAIXA

Registro ANVISA: ISENTO RDC 185

Validade: DE 02 ANOS

Código Alfandegário: 38210000

Certificações: ISO 9001, ISO 13485, (BPF) Boas Práticas de Fabricação, Laudo Analítico de laboratório credenciado ao REBLAS ANVISA

Handwritten signature



Forneceremos 02 incubadora em comodato para o itens 16 e 20 Bionova® MiniBio foi desenhada para a incubação dos Indicadores Biológicos (IBs) Auto-contidos: Os microrganismos contidos nos indicadores biológicos variam de acordo com o processo de esterilização para o qual foram desenhados, por conseguinte, as temperaturas de incubação são diferentes dependendo do indicador. Os indicadores para o controle de esterilização por Óxido de Etileno (OE) devem ser incubados a 37 °C, enquanto que aqueles para os processos de esterilização restantes devem ser incubados a 60 °C. A incubadora Bionova® MiniBio permite a detecção rápida e fácil de indicadores biológicos positivos e negativos. Dispõe de 6 programas de incubação: 4 hs. a 37 °C, 3hs. a 60 °C, 2 hs. a 60°C, 1 h. a 60 °C, 30 min. a 60 °C y Ultra (20 min.) a 60 °C. Um resultado positivo também pode ser evidenciado através da mudança de cor do meio de cultura para amarelo, leia as instruções de uso de cada um dos indicadores para mais informação. A escolha de realizar ou não a incubação estendida para confirmação por mudança de cor depende dos protocolos internos do laboratório ou hospital. A incubadora permite a seleção de programas com

tempos de incubação diferentes para cada uma das 3 posições. A incubadora Bionova® MiniBio permite não só a detecção dos resultados, também fornece um ticket impresso para o registro.

Fabricante: TERRAGENE; Procedência: IMPORTADO ARGENTINA; Marca BIONOVA Modelo: MiniBio; Apresentação: 01 unidade .; Registro ANVISA: ISENTO RDC 185; Garantia: DE 01 ANO.

Quantidade: 09 caixas com 25 unidades

Valor Unitário R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais).

Valor Total R\$ 9.900,00 (Nove Mil Novecentos Reais).

Cordialmente

LETICIA LIMONTA LASSALA MADIO
SÓCIA DIRETORA

CPF: 344.218.988-80

RG: 43.705.597-8 SSP/SP

08.924.87510001-917

BIOVALIC
EQUIPAMENTOS

Rua Antônio ... 180 130925
Vila Mariana ... 130910

SAC

INDICADOR QUÍMICO BOWIE & DICK PACOTE



CHEMDYE - TESTE BOWIE & DICK PACOTE

 **TERRAGENE**
in the health care.

all

INDICADORE QUÍMICO - BOWIE & DICK PACOTE

Os Pacotes de Prova Bowie & Dick Chemdye® foram desenvolvidos para controlar a penetração do vapor e a remoção do ar residual das autoclaves a vácuo. Os Pacotes são compostos por uma série de barreiras permeáveis ao vapor entre as quais se encontra a folha de indicador químico. O teste deverá ser colocado no interior da autoclave em posição horizontal. Durante o ciclo de pré-vácuo o ar deve ser removido do pacote, passando pelas barreiras microbiológicas, bem como após esse processo o vapor deverá penetrar o pacote e chegar até o indicador químico. Os Pacotes de Testes Bowie & Dick Chemdye® são impressos com tinta Chemink® de alta qualidade, livre de metais pesados tóxicos.

O indicador químico interno muda de 'Amarelo' para 'Preto' indicando uma adequada eliminação do Ar. Uma falha na remoção de Ar se evidencia quando uma área de cor mais clara é mostrada no centro da Folha de Bowie & Dick Teste, em comparação com a cor Preta das margens da Folha.

O Teste Bowie & Dick deve ser realizado com frequência diária para evidenciar possíveis problemas no esterilizador, e sempre após as revisões e manutenções dos equipamentos. Caso o resultado do teste se mostre irregular, interdite o equipamento e realize a manutenção do mesmo.

Permitem registrar na própria folha teste as seguintes informações: data, número de controle do ciclo, departamento, número da autoclave, resultado e nome do responsável, além das informações já impressas como: número de lote e data de validade do teste.

Os Pacotes de Prova Bowie & Dick Teste Chemdye® foram desenvolvidos e fabricados seguindo os parâmetros determinados pelas normas EN 867 e ISO 11140 e sob os certificados de gestão de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 13.485:2003.

LEITURA DO RESULTADO



ORIGINAL



SATISFATÓRIO

APRESENTAÇÃO

Código BD125/X2 - Teste Bowie & Dick Pacote (125 x 125 x 16 mm) - Embalagens com 20 unidades



000443

INTEGRON®*Indicadores Emuladores de um ponto*

Classe 6

**Emuladores
IT27-7YS**

Indicadores emuladores de um ponto Integron® Terragene® classe 6 (EN ISO11140-1:2012).

Para controle dos ciclos de esterilização a vapor.

Os produtos asseguram um adequado controle na eficácia dos processos de esterilização (temperatura, tempo, qualidade de vapor). A ampla gama de indicadores emuladores permite selecionar o indicador que mais se adapte ao processo de esterilização a controlar.

Os indicadores emuladores Integron® possuem grande precisão, não são tóxicos, são 100% livres de chumbo e não requerem laminação devido a grande resistência das tintas Chemink®. A curva de performance de cada emulador permite determinar com facilidade a margem de segurança que cada um deles possui.

Os emuladores Integron® foram desenvolvidos com tecnologia química Chemink® e testados com os padrões de qualidade mais exigentes. Integron® oferece um produto de fácil interpretação à medida dos requerimentos de cada processo.

Guia de referência de resultados

Sem processar Processado e correto



Falhas



Um ou mais parâmetros de esterilização não foram alcançados. Os materiais não podem ser considerados estéreis e devem ser processados novamente.

É muito frequente encontrar estes resultados quando a qualidade de vapor é ruim ou não gerou o vácuo adequado.



TERRAGENE

ETIQUETAS

Etiquetas de 21mm x 26mm

Etiquetas com indicador químico de processo, Classe 1 (Norma ISO 11.140-1:2005)


Dupla camada adesiva, possibilita colar a etiqueta no artigo a ser esterilizado e posteriormente nas fichas de controle para rastreabilidade

Dispositivo para acoplar rolos com até 750 etiquetas

Disponíveis para o controle de ciclos a Vapor, ETO, Calor Seco, Plasma de Peróxido de Hidrogênio e Formaldeído.


Possibilita imprimir as seguintes informações: Validade, N° Lote, Data do Processamento (esterilização), entre outros, assim permitindo a identificação e rastreabilidade de caixas e pacotes.

Substitui a necessidade da fita indicadora, reduzindo o custo do processo de esterilização.

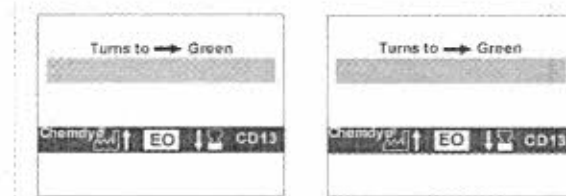


Chemdye

CD13

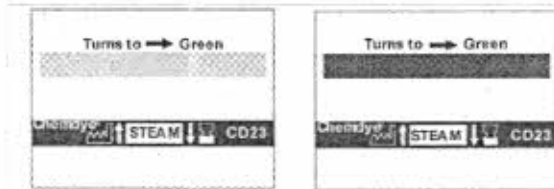


Chemdye

CD23

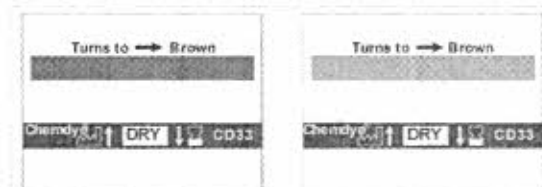


Chemdye

CD33

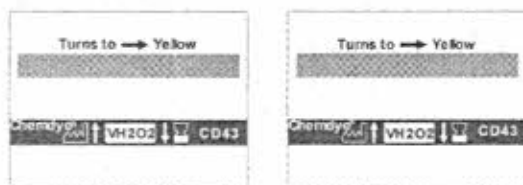

Chemdye

CD43

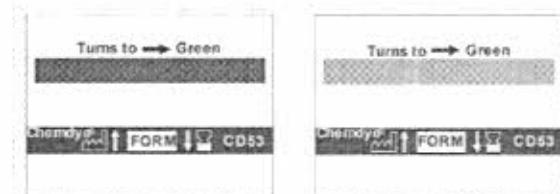

Chemdye

CD53



SISPACK MEDICAL LTDA.

Rua Antonio Fonseca, 280 - CEP 02112-010 - São Paulo - SP - Tel (11) 2955-2222 - Fax (11) 2954-4107 - www.sispack.com.br

all

INDICADORES BIOLÓGICOS DE LEITURA RÁPIDA



LEITURA POR FLUORESCÊNCIA EM 3 HORAS

SISPAC

Handwritten signature or initials.

000446



TERRAGENE



Um ponto Integradores e Emuladores



Integradores Integrator® Classe 5 IT26-1YS

Integrator® Terragene® Integrador Químico Classe 5 de um ponto (EN ISO 11140-1) para verificação de ciclos de esterilização a vapor entre 121 e 134°C.

O produto garante um controle adequado da efetividade do processo de esterilização (tempo, temperatura e qualidade do vapor).

Os indicadores integradores Integrator® possuem alta precisão, atóxico, e mantém sua cor após o processo de esterilização por mais de um ano.

A curva de performance de cada integrador pode facilmente determinar a margem de segurança mantido para cada um deles.


Integradores Integrator® foram desenvolvidos com Chemink® tecnologia química e testados com padrões de alta qualidade. Integrator® oferece um produto de fácil interpretação, adaptados aos requisitos de cada processo.

Modelo: IT26-1YS

Formato: 72 mm x 23 mm


Cores: Amarelo para Preto

Referência de Resultados

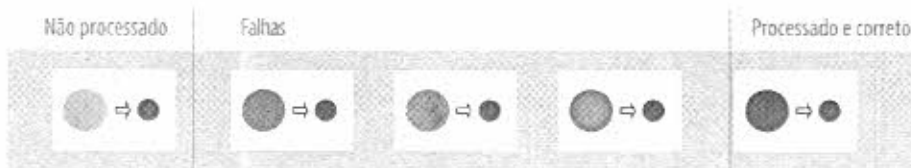


Um ou mais parâmetros de esterilização não estão de acordo. O material não pode ser considerado estéril e deve ser processado novamente. É bem comum encontrar estes resultados quando a qualidade do vapor é deficiente ou quando não é gerado vapor adequado.

Curva de Performance

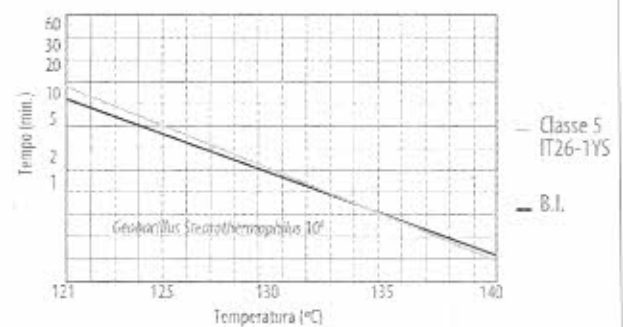

O gráfico mostra a margem de segurança e a performance do integrador em paralelo com o indicador biológico (B.I.) com população nominal de 10^6 .

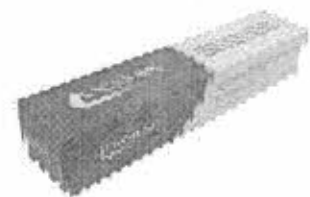

Integrador indicador de um ponto, verificação de ciclo de processo de esterilização a vapor entre 121 a 134°C. EN ISO 11140-1 Classe 5.

IT26-1YS

Embalagem com 200 unidades.

all


33

000447

Steam Test Pack (PCD)

TERRAGENE® BIONOVA®


Dispositivo de desafio de processo (PCD)

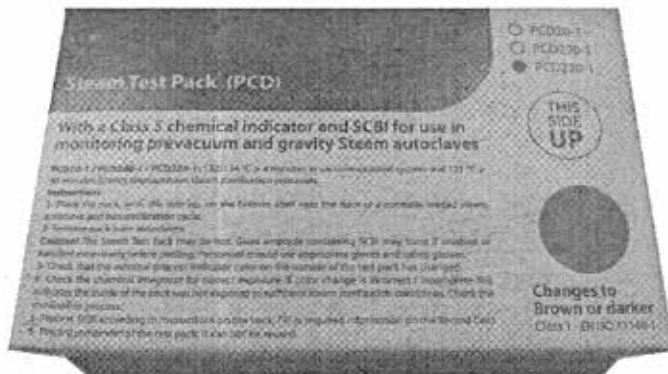

PCD tipo test pack para vapor PCD20-1 PCD200-1 PCD220-1 PCD221-1

Os dispositivos de desafio de processo Bionova® PCD20-1, PCD200-1, PCD220-1 e PCD221-1 foram desenvolvidos para a detecção de remoção inadequada de ar e penetração de vapor em esterilizadores assistidos por vácuo e em esterilizadores de deslocamento de ar por gravidade. São compostos por um indicador de processo Classe 1, um indicador integrador Classe 5 e um indicador biológico autocontido.

O dispositivo de desafio de processo Bionova® PCD20-1 contém um indicador biológico BT20 de leitura em 24 hs.
O dispositivo de desafio de processo Bionova® PCD200-1 contém um indicador biológico BT200 de leitura em 6 hs.
O dispositivo de desafio de processo Bionova® PCD220-1 contém um indicador biológico BT220 de leitura em 3 hs.
O dispositivo de desafio de processo Bionova® PCD221-1 contém um indicador biológico BT221 de leitura em 1 hs.

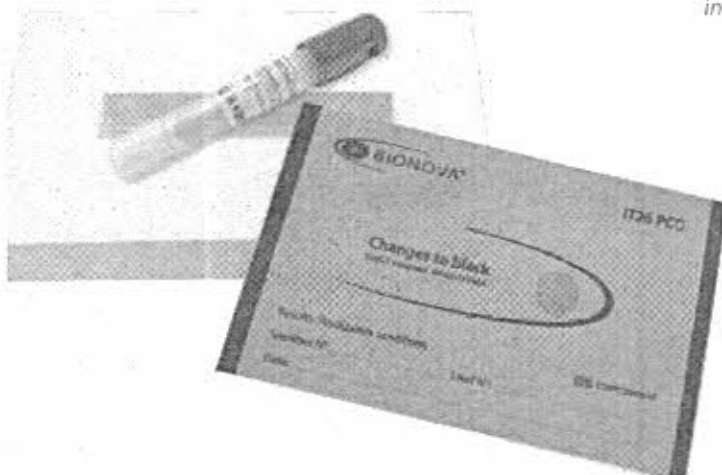

Indicador de processo
Classe 1
Cor inicial: Azul
Cor final: Marrom ou
mais escuro

Indicador químico
Classe 5
Cor inicial: Amarelo
Cor final: Preto




- Para sistemas com e sem vácuo
- Integrador e indicador biológico incorporado
- Resultado indicador integrador imediato
- Resultados biológicos em:

1 h. (PCD221-1)
3 hs. (PCD220-1)
6 hs. (PCD200-1)
24 hs. (PCD20-1)

• Produto isento de registro ANVISA.
Importado e Distribuído por Sispack Medical.

TERRAGENE

Auto-leitora
para Indicadores Biológicos
Rápidos, Súper Rápidos e Ultra Rápidos

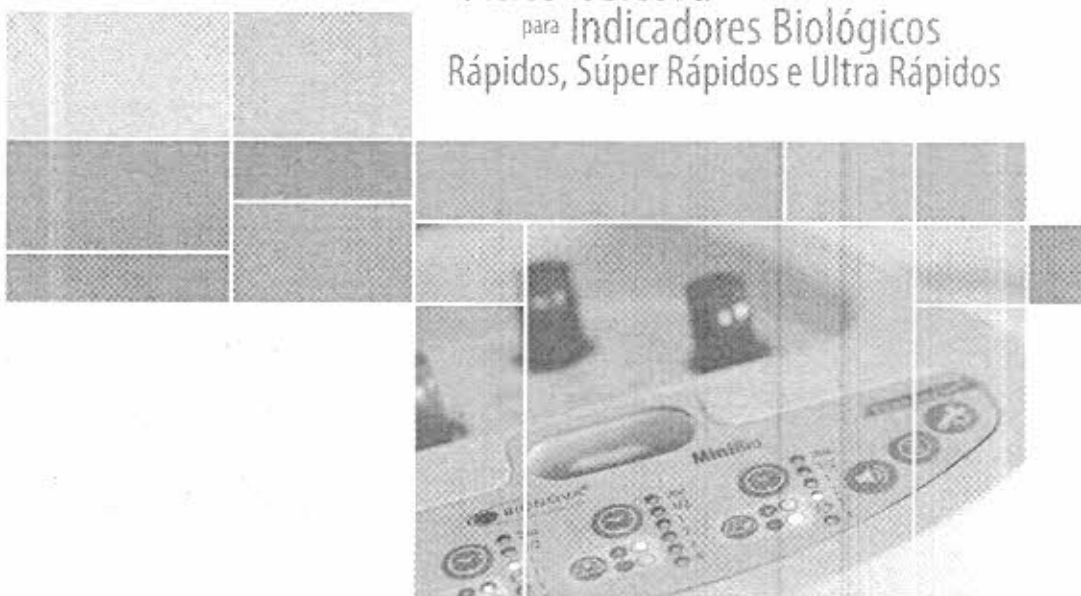

Innovation in technologies for sterilization and disinfection control



MiniBio

TERRAGENE

Rev.2 | Novembro 2017

all

Informação de segurança

Bionova® MiniBio pode ser conectada a um computador através de uma porta USB. A mesma permite associar os resultados com o *Software de Rastreabilidade Bionova®* para Leitura Automática e Rastreabilidade de Indicadores Biológicos Rápidos, Super Rápidos, Ultra Rápidos e Sistema de Monitorização de Higiene. Para descarregar a última versão do software, acessar: <http://www.terra-gene.com.br/produtos/control-de-infeccao/incubador-ras/baixar-o-software/?lang=pt-br>, desde ali também poderá descarregar o manual de uso do software.

Referências

- 1 Tampa protetora.
- 2 Área de incubação.
- 3 Painel de controle.
- 4 Quebra ampolas para IBs (Crusher).
- 5 Cavidade para rolo de papel.
- 6 Impressora térmica.
- 7 Seletor de temperatura.
- 8 Seletores de programas de incubação / tempo restante.
- 9 Luz indicadora de atenção.
- 10 Luz vermelha / Indicador positivo.
- 11 Luz verde / Indicador negativo.
- 12 Posição de incubação.
- 13 Cancelamento alarme sonoro.
- 14 Reimpressão de resultados.
- 15 Botão de Configuração / tração de papel.
- 16 Orifício para controle externo da temperatura.
- 17 Tomada para plugue de alimentação de energia (12 volts CC).
- 18 Porta USB.

Símbolos

-  80% Umidade relativa de operação.
-  30°C Temperatura ambiente de operação.
-  Advertência, precaução.
-  Cuidado: risco de choque elétrico.
-  Precaução: superfície quente.
-  Importante, atenção.
-  Fabricante.
-  Conformidade Europeia.
-  Número de série.
-  Corrente contínua.
-  Denominação de produto.



Para evitar riscos e danos no equipamento:

- Não colocar o equipamento em um ambiente exposto à luz solar direta ou lâmpadas de alta intensidade luminosa.
- Não colocar o equipamento perto de dispositivos que emitam campos eletromagnéticos.
- Não usar o equipamento em superfícies com vibrações.
- Não derrame nenhum líquido no interior.
- Não mergulhe a incubadora em nenhum líquido.
- Use apenas no interior.
- Desligue o cabo de alimentação antes de limpar.
- Não utilize produtos de limpeza ou desinfetantes abrasivos ou corrosivos.
- Em caso de achar uma falha técnica, contatar ao fabricante para a sua assistência. Por favor, evitar abrir e/ou tentar concertar a incubadora, pois isso

Instruções de uso

NOTA: Se o papel para a impressão de tickets acabar, a luz azul de atenção irá piscar rapidamente. Para trocar o papel, siga as instruções de *Reposição do rolo de papel na impressora*. O equipamento salva os últimos 3 resultados, para reimpressão, siga as indicações em *Reimpressão dos últimos resultados*.

BIONOVA	MiniBio	BIONOVA	MiniBio	BIONOVA	MiniBio
INCUBADORA DE	LEITURA RÁPIDA	NUM. SÉRIE XXXX	PROGRAMA XXXX	DATA XXXX	HORA DE SÍMIO XXXX
HORA DE SÍMIO XXXX	HORA DE SÍMIO XXXX	HORA DE SÍMIO XXXX	HORA DE SÍMIO XXXX	HORA DE SÍMIO XXXX	HORA DE SÍMIO XXXX
TUBO DE SÍMIO XXXX	TUBO DE SÍMIO XXXX	TUBO DE SÍMIO XXXX	TUBO DE SÍMIO XXXX	TUBO DE SÍMIO XXXX	TUBO DE SÍMIO XXXX
POSITIVO	NEGATIVO	CANCELADO			

POSITIVO

NEGATIVO

CANCELADO

Especificações papel térmico

O tipo de papel recomendado é JUJO AF50KSE3 ou semelhante (código para encomenda ICTP).

Largura do papel: 58 mm

Peso máximo: 60 g/m²

Diâmetro exterior do rolo: 23 mm

Reposição do rolo de papel



A impressora usa rolos de papel térmico.



1. Para substituir o rolo de papel, abrir a porta da impressora puxando a pega da tampa. Abrir a tampa da impressora e retirar o rolo usado.



2. Colocar o novo rolo de papel com o lado exterior para acima.



3. Fechar a tampa da impressora pressionando os lados da tampa.

NOTA: Pode checar a correta troca de papel, apertando este botão vai forçar o avance de papel por alguns centímetros.

Reimpressão de resultados

A incubadora permite a reimpressão dos últimos 3 resultados de leitura por fluorescência. Para imprimir os resultados, deve manter pressionado o botão durante 3 segundos.

Tempo de incubação restante

A incubadora Bionova® MiniBio permite verificar o tempo restante de incubação de cada posição de leitura através da impressão de um ticket. Enquanto um processo de leitura estiver em andamento, manter pressionado o botão dessa posição por 3 segundos; em seguida, um bilhete vai ser emitido, informando a posição de leitura, o programa utilizado e o tempo de incubação restante.

Para checar o tempo de incubação restante de duas ou mais posições de leitura em andamento, pressionar 2 botões ao mesmo tempo; a incubadora vai emitir um ticket informando o tempo restante de todas as posições.

BIONOVA	MiniBio
INCUBADORA DE	LEITURA RÁPIDA
NUM. SÉRIE XXXX	PROGRAMA XXXX
DATA XXXX	HORA XXXX
TUBO X:	PROGRAMA: XXXX
TEMP. RESTANTE: XXXX	
TUBO X:	PROGRAMA: XXXX
TEMP. RESTANTE: XXXX	

all

Instruções de uso

que a ampola tem que ser retornada para a cavidade correspondente.

Se o indicador não for inserido novamente na cavidade de leitura após 10 segundos de retirado, a leitura vai ser cancelada e o cancelamento vai ser informado através da impressão de um ticket.

Monitoramento de temperatura

A incubadora Bionova® MiniBio contém um controle interno de temperatura. Se a temperatura de incubação estiver fora do intervalo de 37±2 e 60±2 °C, a luz azul do led de temperatura começará piscar.

A temperatura pode ser monitorada externamente usando o termômetro Bionova® TB-IC1020 ou outro similar a este. A Auto-Leitora MiniBio possui uma cavidade especial para colocar o termômetro, localizada no lateral do equipamento.

Cuidados e limpeza

Limpe a superfície externa da incubadora Bionova® MiniBio com um pano umedecido com uma pequena quantidade de detergente. Não limpe o interior da máquina. Se for necessário limpar os componentes internos do equipamento, contatar com o fornecedor ou o fabricante.



Sempre desligue a incubadora MiniBio e deixe esfriar antes de limpar. Não mergulhe o equipamento em líquidos.

NOTA: A incubadora Bionova® MiniBio não precisa manutenção de rotina.

Atualização de firmware

A incubadora MiniBio permite a atualização regular do firmware (software que controla e define as diferentes funcionalidades do equipamento) usando o software Bioupdate. O mesmo permite verificar através da Internet, a última versão de firmware disponível para a incubadora MiniBio; descarregar e instalá-lo em poucos minutos, sem a perda de dados do computador.

O software Bioupdate deve ser descarregado apenas uma vez, através do site: <http://www.terragene.com.br/producao/control-de-infeccao/incubadoras/minibio/>.

Descarregar o arquivo: [Descarregar programa Bioupdate](#)

PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO:

Antes de iniciar o processo, certifique-se que o programa Bionova® esteja fechado. Desligue a incubadora por 5 segundos, ligue-a e continue com as seguintes etapas:

- 1- Conectar a incubadora para o PC através de um cabo USB e certifique-se que você tem uma conexão com a internet.
- 2- Abra o programa Bioupdate.
- 3- Pressione o botão *Start* para atualizar.



4- Aguarde até que o software indique que concluiu o processo de atualização. A incubadora vai emitir um ticket verificando a nova versão do Firmware.

NOTA: Este processo deve ser repetido toda vez que uma nova versão do firmware seja informada, através do site.

Calibração

O protocolo de calibração do equipamento é detalhado no manual do software (*Software de Rastreabilidade Bionova® para Leitura Automática e Rastreabilidade de Indicadores Biológicos Rápidos, Super Rápidos, Ultra Rápidos e Sistema de Monitorização de Higiene*). Para descarregar o manual do software, acessar: <http://www.terragene.com.br/producao/control-de-infeccao/incubadoras/baixar-o-software/?lang=pt-br>.

Modo Configuração


A incubadora Bionova® MiniBio conta com um modo de configuração a partir do qual poderá estabelecer o fuso horário do equipamento e a língua de impressão. Para acessar ao modo Configuração, ligar o equipamento e, ao mesmo tempo, manter pressionado o botão . Os leds vermelhos e verdes das três posições vão permanecer ligados indicando que a incubadora encontra-se nesse modo. A impressora irá imprimir um bilhete, verificando

Tabela de solução de problemas

Falha	Causa possível	Ação
A incubadora não liga.	A fonte de energia não está conectada corretamente.	Verifique se a fonte de alimentação está conectada a uma rede elétrica de acordo com as características da mesma e verifique se a conexão do plugue à incubadora está bem ligada.
A incubadora mostra um erro numa posição no "Auto Teste".	Um indicador biológico está nessa posição ao momento de ligar a incubadora.	Verifique que todas as posições estejam vazias ao ligar o equipamento. Reiniciar o equipamento.
A incubadora mostra um erro no "Auto Teste".	Alguma partícula ou sujeira está obstruindo a passagem da luz entre os sensores.	Verifique a limpeza dessa posição. Para fazer a limpeza recomendamos o uso de ar e evitar o uso de objetos sólidos que podem danificar os componentes internos. Reiniciar o equipamento.
A incubadora não inicia a leitura do indicador biológico. A luz vermelha da posição fica piscando.	O "Auto Teste" achou um erro nessa posição e a mesma ficou anulada.	Verifique que todas as posições estão vazias ao ligar o equipamento. Reiniciar o equipamento.
A incubadora não inicia a leitura de indicadores biológicos em nenhuma posição.	A temperatura de incubação não está estabilizada.	Aguarde até que a temperatura se estabilize.
A incubadora não permite mudar de programa.	Leitura em andamento.	Aguarde até finalizar a incubação dessa posição.
A incubadora não imprime o ticket e a luz de atenção irá piscar rapidamente.	Tampa da Impressora mal fechada. Impressora sem papel.	Checar que a tampa esteja bem fechada. Colocar um novo rolo de papel na orientação correta.
A incubadora emite papel, mas não é impresso.	O rolo de papel foi colocado na orientação incorreta.	Checar a orientação do rolo de papel.
O software de rastreabilidade Bionova® não detecta a incubadora.	A incubadora está desligada ou o cabo USB é desconectado.	Verifique que o equipamento esteja ligado, o cabo USB se encontre corretamente conectado e o porto COM tenha sido reconhecido e corretamente instalado pelo sistema operativo.
Falha a atualização da incubadora.	A incubadora é conectada ao programa de rastreabilidade Bionova®.	Fechar o programa Bionova®, reiniciar o equipamento e tentar novamente.



DECLARAÇÕES

Afirmamos que nos preços contidos na proposta, estão inclusos custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

Afirmamos sob as Penas da lei, que a nossa atende plenamente aos requisitos de habilitação para participação do referido processo, e estamos de acordo com o Edital em sua íntegra.

As garantias respeitarão o mínimo previsto na LEI 8.078 Código de Defesa do Consumidor. A garantia pode se estender de acordo com o edital e de forma expressas e discriminada, em caso de omissão o que prevalecerá sempre será o contido na LEI vigente.

Afirmamos que, sujeitaremos e aceitaremos todas e quaisquer exigências estabelecidas no presente Edital e seus respectivos Anexos, quando houver.

CONDIÇÕES DIVERSAS

A validade da proposta será de 60(sessenta) dias.

O prazo de entrega será de 10(dez) dias a úteis do recebimento da Nota de Empenho.

Condição de pagamento deverá realizada até 30(trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

O local de entrega será na UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, localizada na Rodovia Perimetral Norte, nº 1.510, Bairro: Luther King, PR 180 no município de Francisco Beltrão conforme o presente Edital.

Cordialmente

LETICIA LIMONTA LASSÁLA MADIO
SÓCIA DIRETORA
CPF: 344.218.988-80
RG: 43.705.597-8 SSP/SP

08.924.87510001-917
BIOVALIC S/A - SÓCIO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Rua Antônio Fonseca, 285
Vila Maria - CEP 02112-010
SÃO PAULO - SP

Este conjunto contém 47 folhas, incluindo esta.

Razão Social		HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	
CNPJ		23.866.426/0001-28	
Endereço		RUA JOSE PEDRO BOESSIO, 114 - HUMAITÁ - PORTO ALEGRE/RS	
Representante		Rogério Marobin	
CEP		90250-050	
RG/ CPF		2085967764/ 016.502.440-29	
Fone/ Fax		(51) 3341-6950	
Email		contato@hospbox.com.br	

Cliente		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	
Pregão Eletrônico		206/2018 - PROCESSO 834/2018	

LOTE /ITEM	Quant. Estimada Anual	Descrição	Validade	UND	RMS	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
7	200	Detergente enzimático - limpador multienzimático para limpeza de artigos médico hospitalares, composto de 05 enzimas do grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulases (conforme RDC 55/2012), que facilite a ação de limpeza e proteção do instrumental. Detergente não iônico/aniônico, ph neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida. Pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Apresentação: embalagem de 1 litro, constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade)	24 meses	1 LITRO	325220066	PodersoDet-Enzimatic / Kellodrin	R\$ 39,99	R\$ 7.998,00

- Declaramos estarmos enquadrados na condição de micro empresa prevista na lei complementar 123/06 -


preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto

Validade da Proposta	60 dias	Banco	Banco do Brasil
Prazo de Pagamento	30 dias	Agência	2813-4
Prazo de Entrega	10 dias	Conta	27597-2

- Nos

TOTAL

R\$ 7.998,00

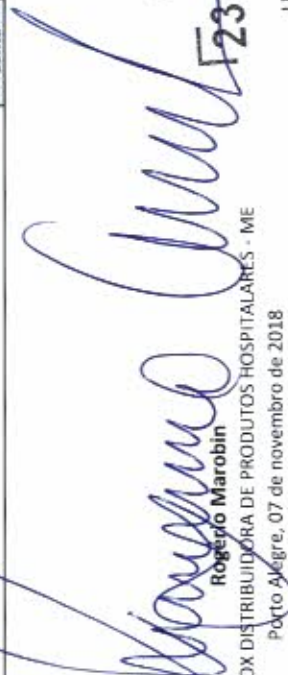
Rogério Marobin
 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME
 Porto Alegre, 07 de novembro de 2018

23.866.426/0001-28

HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE
 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Rua José Pedro Boessio, 114
 Humaitá - CEP 90250-050
 PORTO ALEGRE - RS

000455

Razão Social	HOSPBX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
CNPJ	23.866.426/0001-28		
Endereço	RUA JOSE PEDRO BOESSIO, 114 - HUMAITÁ - PORTO ALEGRE/RS		
Representante	Rogério Marobin	RG/ CPF	2085967764/ 016.502.440-29
CEP	90250-050	Fone/ Fax	(51) 3341-6950
		Email	contato@hospbx.com.br

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO		
Pregão Eletrônico	206/2018 - PROCESSO 834/2018		

LOTE /ITEM	Quant. Estimada Anual	Descrição	Validade	UND	RMS	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
7	200	Detergente enzimático - limpador multienzimático para limpeza de artigos médico hospitalares, composto de 05 enzimas do grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulases (conforme RDC 55/2012), que facilite a ação de limpeza e proteção do instrumental. Detergente não iônico/aniónico, ph neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida. Pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Apresentação: embalagem de 1 litro, constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade)	24 meses	1 LITRO	325220066	PodersoDet.Enzimatic / Keildrin	R\$ 39,99	R\$ 7.998,00
- Declaramos estarmos enquadrados na condição de micro empresa prevista na lei complementar 123/06 - preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto								
Validade da Proposta	60 dias							
Prazo de Pagamento	30 dias							
Prazo de Entrega	10 dias							
						Banco	Banco do Brasil	
						Agência	2813-4	
						Conta	27597-2	
							TOTAL	R\$ 7.998,00

Rogério Marobin

Rogério Marobin
HOSPBX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME
Porto Alegre, 07 de novembro de 2018

Detalhe do Produto : PODEROSO DETERGENTE MULTENZIMÁTICO

Nome da Empresa:	KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME	
CNPJ:	03.237.999/0001-74	Auditoria, S/A: 30/25771
Produto:	PODEROSO DETERGENTE MULTENZIMÁTICO	
Categoria:	DETERGENTE ENZIMÁTICO	
Registro:	325220066	
Processo:	25351.1/2006-4/2013-26	
Vencimento do Registro:	03/2019	

Rótulo

Visualizar 2º rótulo

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Aprcs.	Data de Publicação
FRASCO	LIQUIDO	1	05/03/2014
Validade:	24 meses	Registro:	3252200660014
Embalagem:	PLASTICO - Primária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Aprcs.	Data de Publicação
BOMBONA PLASTICA	LIQUIDO	2	05/03/2014
Validade:	24 meses	Registro:	3252200660027
Embalagem:	DOMDONA PLASTICA - Primário		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME - DRAGIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

VOLTAR



Pinhais, 07 de novembro de 2018.

À
PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO
FRANCISCO BELTRÃO / PR

PREGÃO ELETRÔNICO 206/2018 - PROCESSO Nº 834/2018

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
10	100	UND	65645 - Escova com cerdas em nylon macias para limpeza de instrumentais cirúrgicos. Com cabo plástico em formato anatômico. Conforme RDC 185/2001. Apresentação: unidades, constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). COD.: 28-72550 - 184x38mm RMS.: ISENTO	BATRIK	110,00	11.000,00
11	100	UND	65646 - Escova de mão, uso único com cerdas enfileiradas para facilitar a limpeza, com forma anatômica que encaixa na palma da mão, que atenda a RDC 185/2001. Apresentação: unidades, constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade) . COD.: 50-40911 RMS.: ISENTO	BATRIK	36,60	3.660,00
12	10	UND	65647 - Escova reutilizável para limpeza de canulados longos, com cabo rígido e comprimento de 230 cm, pontas arredondadas, escova com 8 mm, este produto é isento de registro no MS conforme RDC 185/2001. Apresentação: unidades, constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). COD.: 41-23008 - 8x230mm RMS.: ISENTO	BATRIK	150,00	1.500,00
22	2	UND	65657 - Rolo de fita adesiva para identificação de instrumentais cirúrgicos por cores, resistente, rolo na cor azul. Com mais de 7 (sete) metros de comprimento por rolo e mais de 0,50cm de largura, este produto é isento de registro no MS. Conforme RDC 185/2001 apresentação: unidades, constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). RMS.: ISENTO	BATRIK	128,43	256,86
23	2	UND	65658 - Rolo de fita adesiva para identificação de instrumentais cirúrgicos A por cores, resistente, rolo na cor amarela com mais de 7 (sete) metros de comprimento por rolo e mais de 0,50cm de largura, este produto é isento de registro no MS conforme RDC 185/2001. Apresentação: unidades, constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). RMS.: ISENTO	BATRIK	128,43	256,86
24	2	UND	65659 - Rolo de fita adesiva para identificação de instrumentais cirúrgicos V resistente, rolo na cor vermelha. Com mais de 7 (sete) metros de comprimento por rolo e mais de 0,50cm de largura. Este produto é isento de registro no MS conforme RDC - 185/2001. Apresentação: unidades, constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). RMS.: ISENTO	BATRIK	128,43	256,86
TOTAL:						16.930,58
(Dezesseis mil, novecentos e trinta Reais e cinquenta e oito centavos)						

Validade da proposta: 60 dias conforme edital.

Prazo de entrega: Conforme edital

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias conforme condições previstas no edital;

Local de entrega: Conforme nota de empenho e/ou similar.

Apresentação dos valores: Valores na moeda corrente nacional (Real),.

Dados Bancários: Banco do Brasil: Agencia 2456 Conta Corrente: 68268-3

- Declaro sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo e cumpro integralmente todas as normas e requisitos do Edital e seus anexos, sendo que o(s) material (ais) ofertado(s) atende(m) plenamente a especificação contida no referido edital.
- Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a esta licitação e manifestamos plena concordância com as condições estabelecidas no edital desta licitação
- Declaramos ainda que cumpriremos rigorosamente toda a legislação específica aplicável ao objeto desta licitação, especialmente, mas não exclusivamente, as determinações contidas na Lei Federal 6360/76, no Decreto Federal 79097/77 e na Lei Federal 9782/99 do Ministério da Saúde.
- Declaramos também que cumpriremos com todos os termos da Ata de Registro de Preços a ser firmada.
- Declaramos também que a nossa empresa se encontra enquadrada nos termos da Lei 123/06 de Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, usufruindo assim dos benefícios por ela profetizados.



Ricardo Moura de Lima - Sócio-Gerente
RG: 7.413.617-6
CPF: 022.408.739-81

28.537.922/0001-51

RBR MEDICAL

RUA: MANDAGUAÇU, Nº 294 - Loja 08
EMILIANO PERNETA - CEP: 83.324-430
PINHAIS - PR

Pinhais, 28 de novembro de 2018.

À
PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO
 FRANCISCO BELTRÃO / PR

PREGÃO ELETRÔNICO 206/2018 - PROCESSO N° 834/2018

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	RS UNIT.	RS TOTAL
19	300	UND	65654 - Monitor químico para lavadora ultrassônica: indicador químico para monitorar a eficácia da limpeza nos processos utomatizados em lavadoras ultrassônicas, permitindo identificar falhas no processo de limpeza, verificando o tempo, a temperatura, cavitações, a concentração ideal de detergente e a eficiência do banho de enzimas. Apresentação: Unidades, constando dados de identificação (n° lote, data de fabricação e validade). COD.: WC-101 RMS.: ISENT0	STERITEC	10,41	3.123,00
					TOTAL:	3.123,00
						(Três mil, cento e vinte e três Reais)

Validade da proposta: 60 dias conforme edital.

Prazo de entrega: Conforme edital

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias conforme condições previstas no edital;

Local de entrega: Conforme nota de empenho e/ou similar.

Apresentação dos valores: Valores na moeda corrente nacional (Real),.

Dados Bancários: Banco do Brasil: Agência 2456 Conta Corrente: 68268-3


• Declaro sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo e cumpro integralmente todas as normas e requisitos do Edital e seus anexos, sendo que o(s) material (ais) ofertado(s) atende(m) plenamente a especificação contida no referido edital.

• Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a esta licitação e manifestamos plena concordância com as condições estabelecidas no edital desta licitação

• Declaramos ainda que cumpriremos rigorosamente toda a legislação específica aplicável ao objeto desta licitação, especialmente, mas não exclusivamente, as determinações contidas na Lei Federal 6360/76, no Decreto Federal 79097/77 e na Lei Federal 9782/99 do Ministério da Saúde.

• Declaramos também que cumpriremos com todos os termos da Ata de Registro de Preços a ser firmada.

• Declaramos também que a nossa empresa se encontra enquadrada nos termos da Lei 123/06 de Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, usufruindo assim dos benefícios por ela proferidos.


 Ricardo Moraes de Lima - Sócio-Gerente
 RG: 7.413.617-6
 CPF: 022.408.739-81

28.537.922/0001-51

RBR MEDICAL

RUA: MANDAGUAÇU, Nº 294 - Loja 08
 EMILIANO PERNETA - CEP: 83.324-430
 PINHAIS - PR

RBR COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA
 Rua Mandaguauçu, 294 - Loja 08 - Emiliano Pernetá - CEP 83324-430 Pinhais PR
 F: (41) 3668-2195 e-mail: licita.hospitalar@rbrmedical.com.br

À
PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Francisco Beltrão – PR

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 206/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 834/2018

PLANILHA DE PROPOSTA

Item	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
09	Escova com cerdas rígidas, autoclavável, fabricadas em nylon para limpeza de instrumentais cirúrgicos, conforme RDC 185/2001. Apresentação: unidades, constando os dados de identificação (nº de lote data de fabricação e validade). Marca/Fabricante: Sterilex. Modelo: W21 1296. Procedência: Brasil. Registro M.S.: Dispensado, conforme RDC 260.	Unidade	100	R\$ 59,00	R\$ 5.900,00

Os preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto

A Sterilex Científica Ltda. – EPP, CNPJ: 03.541.994/0001-41, declara de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar 123/06.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias.
Banco do Brasil – Agência: 1192 – 4 – Conta Corrente: 101650-4

São Paulo, 07 de Novembro de 2018.

03.541.994/0001-41

STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP

Rua Dr. João Batista de Lacerda, 168
Mooca - CEP 03177-010
São Paulo - SP



Marcelo Lima da Ressurreição
CPF: 114.449.478-85



PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 834/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de produtos e materiais a serem utilizados na Central de Material Esterilizado – CME da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA 24 horas, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas, cabendo a Secretaria Municipal de Saúde, informar à Comissão se os produtos ofertados atendem às exigências técnicas alvitradas.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, relativa à licitação em epígrafe:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Compressa cirúrgica (campo operatório) medindo 45x50cm, pré-lavada, confeccionada com fios 100% algodão, em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, com placa radiopaca. Contendo 55 a 60% de sulfato de bário ou com fio radiopaco. O tecido é fechado nas extremidades com costura para reforçar, o mesmo e evitar o seu desfiamento. Apresentação: embaladas em pacotes plásticos com 50 unidades, com registro na ANVISA.	PROCSEL	PCT	10	R\$ 168,33	R\$ 1.683,30

VALOR UNITÁRIO: R\$ 168,33 (Cento e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)

VALOR TOTAL: R\$ 1.683,30 (Hum Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Trinta Centavos)

MARCA: PROCSEL

FABRICANTE: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

EMBALAGEM: Pacote com 50 Unidades

REGISTRO: Nº 80649380006

PROCEDÊNCIA: BRASIL

CONDIÇÕES GERAIS

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de Pregão Eletrônico.

Validade dos Produtos: não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) na data da entrega.

Condição de Pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva Nota Fiscal e CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL.

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico.

**DECLARAMOS, que:**

- a) nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.
- b) cumprimos todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.
- c) nos enquadrados na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar 123/06.

DADOS BANCÁRIOS:

Caixa Econômica Ag. 1026 - Conta Corrente 2195-3 Operação: 003
Banco do Brasil: Ag: 287-9 Conta Corrente: 217215-1

DADOS CADASTRAIS:

TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI – ME
RUA DOIS S/Nº - QUADRA 08 – LOTE 08
SALA 003 – CEP: 29.168-030 - CIVIT I – SERRA (ES)
CNPJ. Nº 26.262.981/0001-39
INSC. EST. Nº 083.195.10-6
Fone: (11) 2528-2989 Fax: (11) 2589-5400
E-mails: licitacao.sp@tethi.com.br – cirillo@tethi.com.br

Serra, 07 de novembro de 2018.

「26.262.981/0001-39」

TETHI COMERCIO DE ARTIGOS
MEDICOS E ORTOPEDICOS
EIRELLI LTDA ME

Rua Dois, S/N, Quadra 008 Lote 008 Sala 003
Bairro/ Distrito: CIVIT I - CEP: 29.168-030

「 SERRA - ES 」

Luana Guedes Feitosa
TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI – ME
Luana Guedes Feitosa
Representante Legal
RG 46.675.175-8
CPF 372.833.398-09